




MEDIZINTECHNIK

Prozess Digitalisierung: EKG am UKL



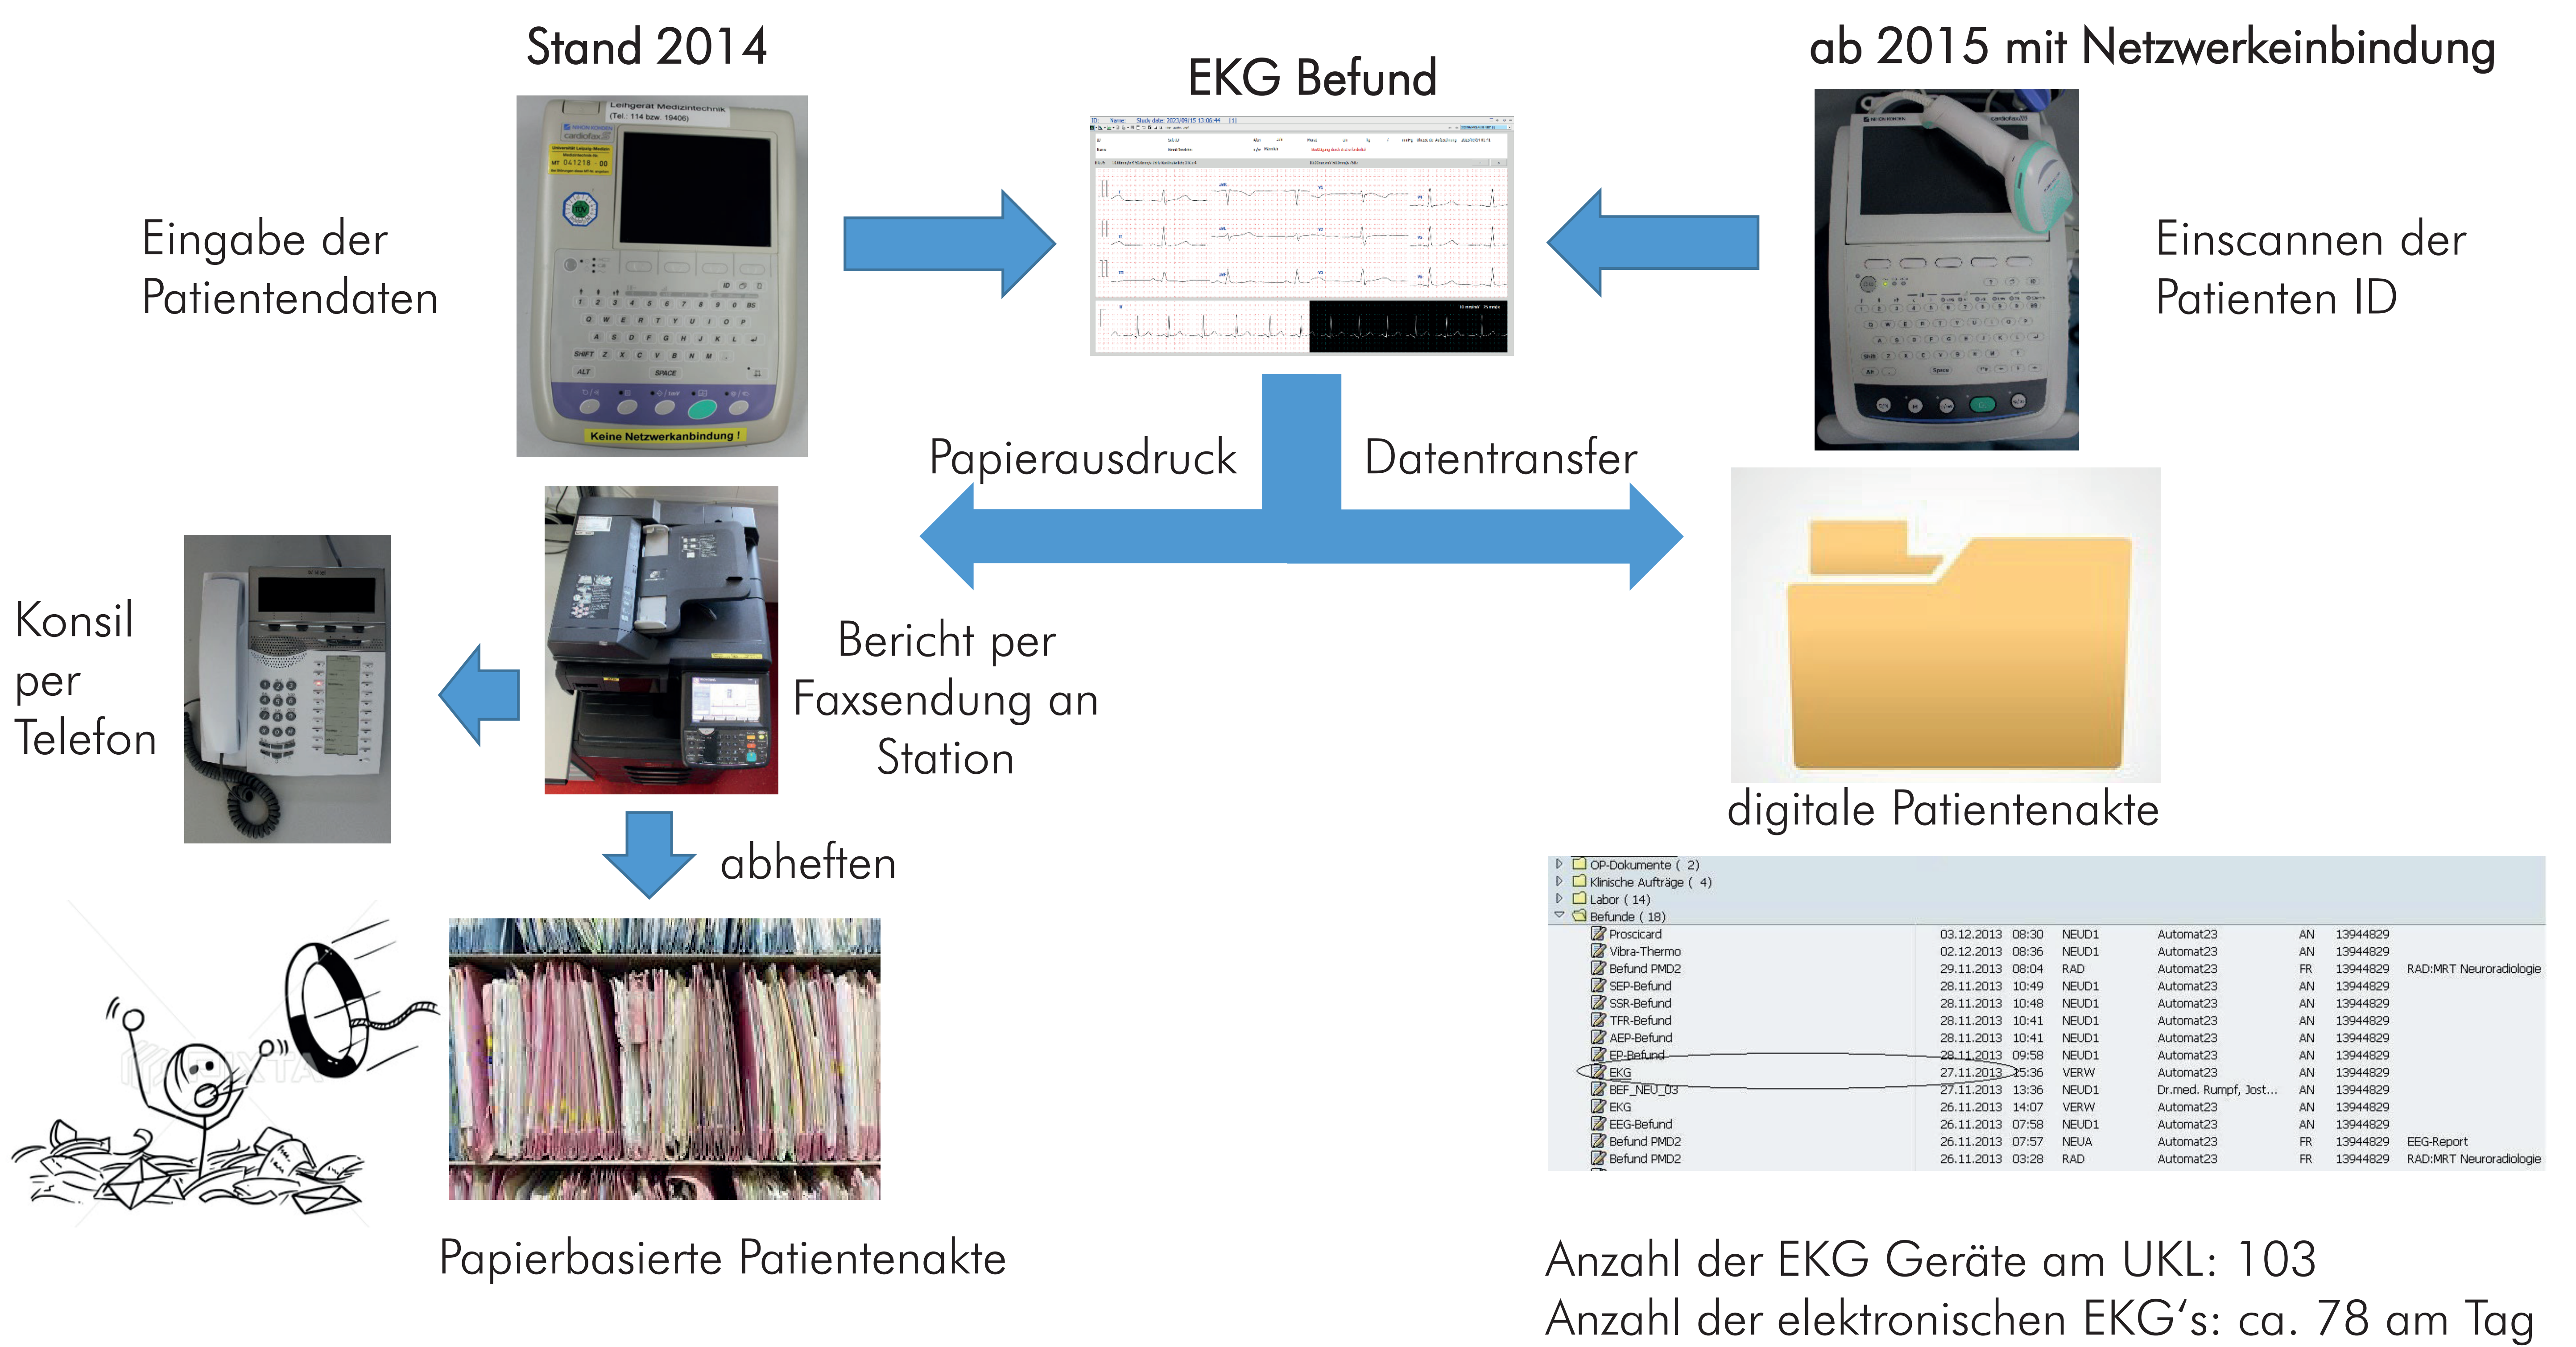


MEDIZINTECHNIK

BGA-Befunde am UKL


2023

Mit automatischen Ausdruck vom BGA Befund

kein automatischer Ausdruck vom BGA Befund


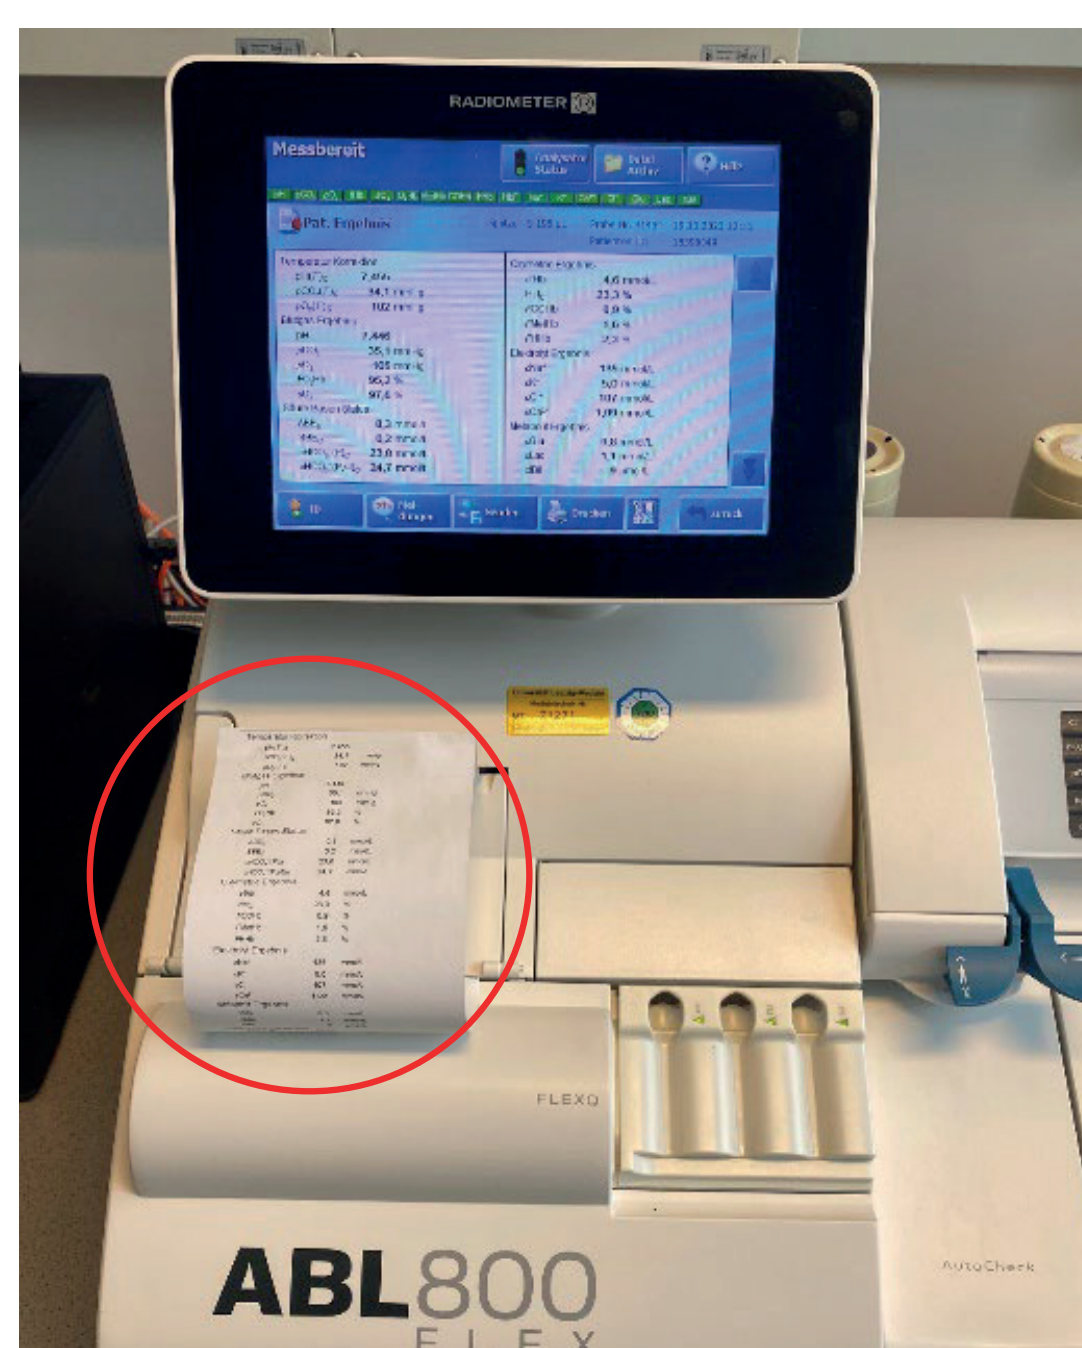


abheften

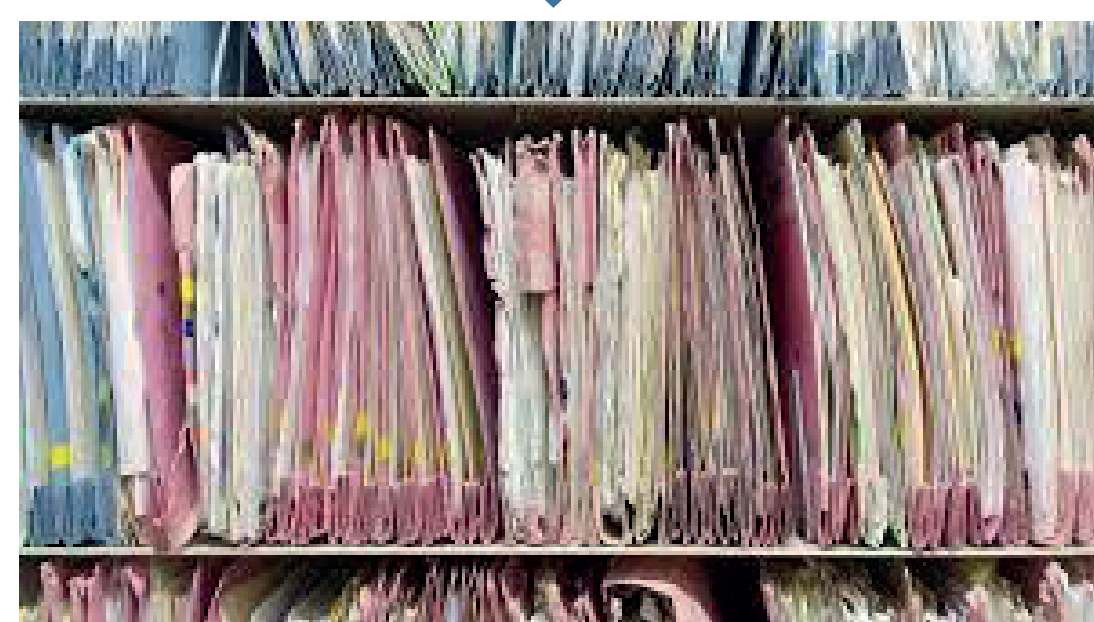

konventionelle Patientenakte

Datentransfer

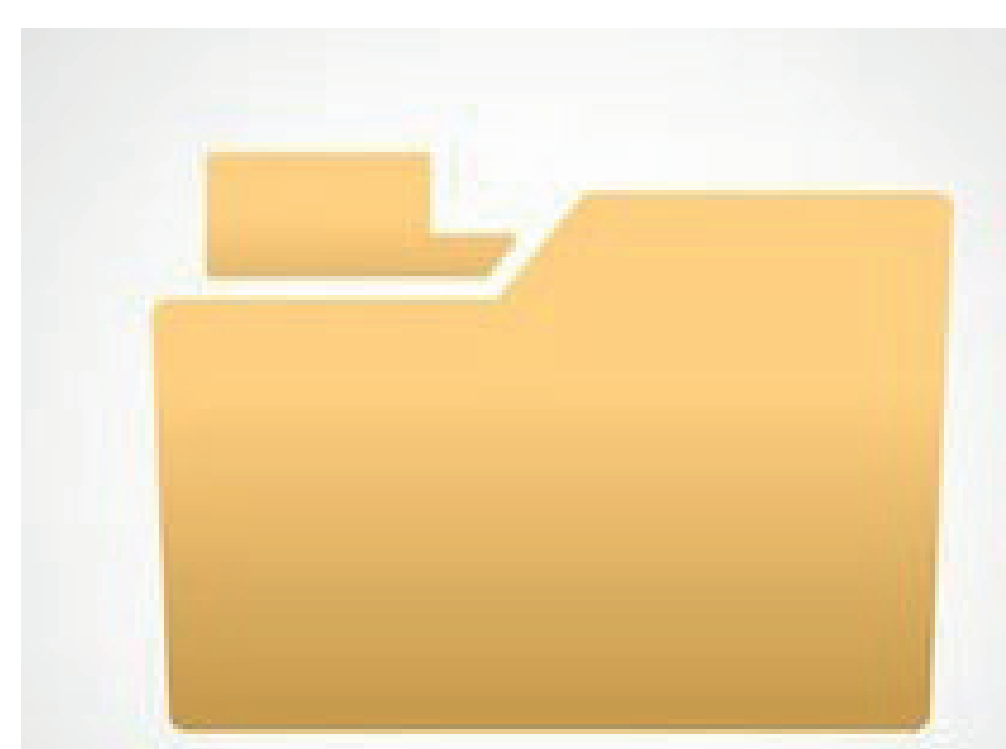

digitale Patientenakte



Anzahl der BGA Geräte am UKL: 32

Anzahl der elektronischen BGA ca. 700 am Tag



MEDIZINTECHNIK

Austausch von defekten Zubehör der Medizinprodukte

Eigenständige Entsorgung



Erhaltene Aufträge in
Medizintechnik:

Bitte 3 x
Manschette

Bitte 5 x
EKG Kabel

Bitte 10 x
Kabel

➔ Austausch erfolgt 1:1 nur gegen
Zusendung des defekten
Zubehörs

Gründe : Recycling, Kosten, Lagerung

